

**Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA**

2019

**À PREFEITURA DE LUÍZ ALVES**

**Ref: PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2019 FMS**

MUNICÍPIO DE LUÍZ ALVES  
RECEBIDO

12 DEZ. 2019 16:51

LICITAÇÃO

## RECURSO

A empresa **MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA** ME com sede jurídica na cidade de São José– Santa Catarina, situada à Rua Jurerê, 100 – Bela Vista III CEP 88.110-770 e devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 15.229.902/0001-71, vem, mui respeitosamente, à honrosa presença de V. Sas., interpor PEÇA RECURSAL, contra as empresas VL FUZETI, MULTIHOSP e SANIMED, com base nos argumentos a seguir.

### **DA FUNDAMENTAÇÃO**

A empresa MCA, no interesse de participar do processo de pregão presencial nº 13/2019 FMS, buscou o edital do referido processo.

Como é de sua responsabilidade o cumprimento ao edital, buscamos todas as informações para que pudéssemos apresentar proposta dentro da real necessidade do Fundo Municipal de Saúde, com isso ofertamos os itens que atendem na íntegra ao descritivo solicitado.

O mesmo não ocorre com nossos concorrentes para o item 15, conforme podemos observar:

MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA EPP – CNPJ: 15.229.902/0001-71  
Rua Jurerê, nº100 – Cep: 88110-770 – Bela Vista III – São José – SC.  
e-mail: [assistencia@mcahospitalar.com.br](mailto:assistencia@mcahospitalar.com.br) Fax: (48)3258-8227

Quanto aos itens 08 e 36 - Cama Fowler Elétrica é solicitado o seguinte descritivo.

" ASPIRADOR DE SECREÇÃO, PORTÁTIL, **COM FLUXO DE ASPIRAÇÃO LIVRE DE NO MÍNIMO 50L/MIN.** DEVERÁ CONTER FRASCO AUTOLAVÁVEL, TRANSPARENTE, GRADUADO, COM BOCA LARGA E CAPACIDADE MÍNIMA DE RESERVATÓRIO DE 05 LITROS. TAMPA DO FRASCO COM VEDAÇÃO HERMÉTICA E AUTOCLAVÁVEL. VACUÔMETRO DE 0 A 30 POL/HG E BOMBA ISENTA DE ÓLEO. CONTROLE DE VÁCUO **QUE PERMITA ASPIRAR NO MÍNIMO DE 0 A 25 POL/HG.** SISTEMA DE ACIONAMENTO POR **PEDAL SEM CONDUÇÃO ELÉTRICA.** GABINETE RESISTENTE À CORROSÃO COM RODÍZIOS E COM FREIO. FILTRO DE AR. **PROTEÇÃO CONTRA EXTRAVASAMENTO OU COM LIMITADOR DE NÍVEL.** ALIMENTAÇÃO 220V. GARANTIA NA MÍNIMA DE 01 ANO. ACESSÓRIOS: MANGUEIRA DE SILICONE COM METRAGEM MÍNIMA DE 1,50 M, MANUAL DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO COM O MESMO CONTEÚDO APRESENTADO À ANVISA.."

A empresa vencedora do processo foi a empresa VL Fuzeti Comercial, ofertando aspirador da Marca HR Hospitalar.

A marca ofertado pela empresa vencedora, não atende as especificações do edital no quesito pedal sem condução elétrica e fluxo de aspiração de no mínimo 50l/min. Vejamos:



DESCRIÇÃO	Mod. INL – 6005- BE	Mod. INL – 6005-CBE	Mod. INL – 6005-C2BE
Tensão Alimentação (V)	BIVOLT. AUTOMATICO	BIVOLT. AUTOMATICO	BIVOLT. AUTOMATICO
Frequência (Hz)	50/60 HZ	50/60 HZ	50/60 HZ
Consumo Aproximado	120 w.	120 w.	120 w.
Potência do Motor	1/3 HP ¼ HP	1/3 HP ¼ HP	1/3 HP ¼ HP
Corrente dos Modelos (A)	A BATERIA 12 V. 127 2,0(A) 220 1,1(A) BIVOLT. 2,0(A)	A BATERIA 12 V. 127 2,0(A) 220 1,1(A) BIVOLT. 2,0(A)	A BATERIA 12 V. 127 2,0(A) 220 1,1(A) BIVOLT. 2,0(A)
Vazão L/min.	25 L/min. 36 L/min.	25 L/min. 36 L/min.	25 L/min. 36 L/min.

Quanto ao equipamento ofertado pela empresa Multihosp, da marca Olidef, não atende ao requisito de pedal sem condução elétrica e também não possui fluxo de aspiração de 50 l/min. Vejamos

#### Especificações Mecânicas


Altura	213 mm
Largura	186 mm
Profundidade	286 mm
Peso	9kg
Peso Embalado	9kg
Fluxo máximo	25 L/min
Vácuo máximo	22 Pol Hg (diâmetro de borracha) 27 Pol Hg (pistão de alumínio)

#### 1.6.1 - SIMBOLOGIA UTILIZADA NO EQUIPAMENTO

Leia e entenda o significado desses símbolos antes de utilizar a Aspirador A45 - PLUS.

Quanto ao equipamento ofertado pela empresa Sanimed, marca Dorja, não atende ao requisito de pedal sem condução elétrica e também não fornece o fluxo mínimo de aspiração de 50 l/min. Vejamos.



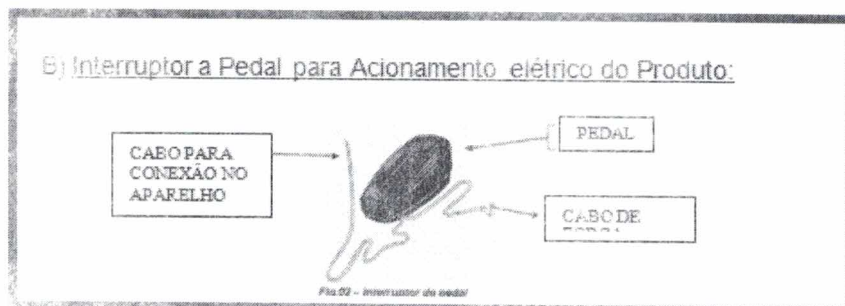

OBS. Para os modelos MD100 E MD300 as bases dos produtos poderão ser de plástico (Vacum forming) ou chapa metálica estampada, dependendo da utilização que se fará.

#### Conteúdo desta embalagem

#### Especificações e Características Técnicas

Bomba de Vácuo tipo pistão  
Vácuo máximo de 25 polegadas de Hg  
Vazão livre 47 lts/min.  
Capacidade do Filtro Gelatinoso 2 X 2 litros  
Motor de 1/4 HP  
\*\*Voltagem automática

Como podemos observar nenhuma das 3 empresas estão atendendo na íntegra ao descritivo do edital. A empresa MCA, ofertou o produto que atende rigorosamente aos requisitos, fato este de seu produto ter um preço superior.

Dessa forma a empresa Stokmed ofertou produto que não atende ao edital, merecendo ser desclassificada.

Quanto ao item 33 - Ventilador Pulmonar de Transporte é solicitado o seguinte descritivo.

MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA EPP – CNPJ: 15.229.902/0001-71  
Rua Jurerê, nº100 – Cep: 88110-770 – Bela Vista III – São José – SC.  
e-mail: [assistencia@mcahospitalar.com.br](mailto:assistencia@mcahospitalar.com.br) Fax: (48)3258-8227

"VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO PARA SUPORTE VENTILATÓRIO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS. CICLADO A VOLUME, TRANSPORTÁVEL INTRA/EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS MODALIDADES CMV (VENTILAÇÃO MANDATÓRIA CONTROLADA), A/C (VENTILAÇÃO ASSISTIDA/CONTROLADA), SIMV (VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA). PARÂMETROS VOLUME CORRENTE DE 50 A 1000ML, PRESSÃO INSPIRATÓRIA DE 0 A 80CMH2O, TEMPO INSPIRATÓRIO DE 1SEG, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 5 A 30 RPM E SENSIBILIDADE POR PRESSÃO, PEEP 0 A 20CMH2O, FIO2 50 A 100%. ALARME PRESSÃO LIMITE, DESCONEXÃO, BATERIA FRACA E PRESSÃO DE O2, COM INTERFAÇE BLENDER COM AR ASPIRADO DO AMBIENTE PARA CONCENTRAÇÕES DE O2 DE NO MÍNIMO 50 A 100%. OUTRAS FUNÇÕES, SILENCIADOR DE ALARME 120SEGUNDOS E NEBULIZADOR. ACOMPANHA: CIRCUITOS RESPIRATÓRIOS COMPLETOS, EXTENSÃO DE OXIGÊNIO, VÁLVULAS UNIDIRECIONAIS, VÁLVULA DE PEEP AJUSTÁVEL DE 0 A 20CMH2O, CONVERSOR AC/DC, SUPORTE PARA FIXAÇÃO EM MACA, AMBULÂNCIA E UNIDADES MÓVEIS DE RESGATE, INCLUSIVE AEREO. ALIMENTAÇÃO 100 OU 220 VAC, 50HZ, BATERIA EXTERNA 12VDC E BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 5 HORAS, PESO MÁXIMO DE 4.8 KG."

Quanto a empresa Leistung.

O equipamento ofertado pela mesma, de acordo com o próprio catálogo apresentado, possui peso de 4,9kg, enquanto que o edital determina que o máximo é de 4,8kg.

Também não foi localizado no prospecto apresentado o suporte para macas, de suma importância para este tipo de equipamento.

Apesar de não constar no catálogo, de acordo com o manual do equipamento, o silenciador de alarme é apenas de 60 segundos, e não 120 segundos conforme pede o edital.

Outro ponto a ser questionado, de acordo com o catálogo o equipamento atenderia na pressão inspiratória, porém de acordo com o manual a pressão inspiratória do equipamento é de 1 a 80cmH2O, enquanto o edital pede de 0 a 80 cmH2o.

Dessa forma a empresa Leistung ofertou equipamento que não atende ao descritivo mínimo do edital.

Quanto a empresa Magnamed.

O equipamento ofertado pela Magnamed não possui opção de bateria externa 12 v conforme pede o edital.

Também é solicitado no edital pressão inspiratória de 0 a 80cmH<sub>2</sub>O, o equipamento ofertado pela Magnamed faz somente de 0 a 60cmH<sub>2</sub>O.

Quanto ao Item 34 - Ventilador Pulmonar, o edital solicita o seguinte descritivo.

"VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO (PRESSÃO E VOLUME), ADULTO/INFANTIL COM TRAQUEIA ADUL/INFA/NEONATO VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO PARA SUPORTE VENTILATÓRIO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO, CONTROLADO A VOLUME E A PRESSÃO. O VENTILADOR DEVERÁ POSSUIR TELA GRÁFICA EM LCD COLORIDO, TOUCHSCREEN DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS, COM MONITORIZAÇÃO DOS GRÁFICOS DE PRESSÃO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, FLUXO X TEMPO E ETCO<sub>2</sub> X TEMPO. LOOPS VOLUME X PRESSÃO E FLUXO X VOLUME. DEVE REALIZAR AS SEGUINTESS MODALIDADES VENTILATÓRIAS VOLUME CONTROLADO, PRESSÃO CONTROLADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO LIMITADA, VENTILAÇÃO A PRESSÃO CONTROLADA COM VOLUME GARANTIDO, VENTILAÇÃO COM DOIS NÍVEIS DE PRESSÃO, CPAP/PS, VENTILAÇÃO MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA A VOLUME E PRESSÃO, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA. COM OS PARÂMETROS AJUSTÁVEIS DE: VOLUME CORRENTE DE 10 A 2000 ML, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE 5 A 150 RPM, AJUSTE DE FLUXO CONSTANTE, DECRESCENTE E SENOIDAL, PRESSÃO CONTROLADA ATÉ 80CMH<sub>2</sub>O, PEEP DE 0 A 50 CMH<sub>2</sub>O, PRESSÃO DE SUPORTE ATÉ 50CMH<sub>2</sub>O, TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO 0,3 A 5 SEGUNDOS, FLUXO INSPIRATÓRIO ATÉ 180L/MIN, SENSIBILIDADE A FLUXO DE 0,5 A 15L/M, OU, **PRESSÃO 0 A -20CMH<sub>2</sub>O, PRESSÃO DE ENTRADA DE GASES DE NO MÍNIMO 90PSI, BIVOLT AUTOMÁTICO, BATERIA COM AUTONOMIA DE 150 MINUTOS, BLENDER ELETRÔNICO COM AJUSTE DE FIO<sub>2</sub> DE 21 A 100%, UMIDIFICADOR AQUECIDO COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA DE 28°C A 37°C, COM ALARME VISUAL DE BAIXA UMIDADE E TEMPERATURA ALTA,** MONITORIZAÇÃO DOS VALORES DE PICO DE PRESSÃO, PRESSÃO MÉDIA, PRESSÃO PLATÔ, AUTO-PEEP, VOLUME CORRENTE INSPIRADO E EXALADO, COMPLACÊNCIA ESTÁTICA E DINÂMICA, RESISTÊNCIA DAS VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, FIO<sub>2</sub>. SISTEMA DE ALARMES: VOLUME CORRENTE ALTO E BAIXO, VOLUME MINUTO ALTO E BAIXO, PRESSÃO INSPIRATÓRIA ALTA E BAIXA, PEEP ALTO E BAIXO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA ALTA E BAIXA, FIO<sub>2</sub> ALTA E BAIXA, ETCO<sub>2</sub> ALTO E BAIXO, BATERIA BAIXA, PRESSÃO DE REDE DE AR, AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, INOPERANTE, OBSTRUÇÃO, DESCONEXÃO. OUTRAS

MCA Comércio e Assistência Técnica Hospitalar LTDA EPP – CNPJ: 15.229.902/0001-71

Rua Jurerê, nº100 – Cep: 88110-770 – Bela Vista III – São José – SC.

e-mail: [assistencia@mcahospitalar.com.br](mailto:assistencia@mcahospitalar.com.br) Fax: (48)3258-8227



FUNÇÕES: BACKUP E TODOS OS MODOS ESPONTÂNEOS, TENDÊNCIAS ARMAZENADA DURANTE 24HS, OFERTA TEMPORIZADA DE OXIGÊNIO, POSSIBILIDADE DE INALAÇÃO SINCRONIZADA NA FASE INSPIRATÓRIA, TGI, SUSPIRO, PAUSA INSPIRATÓRIA MANUAL, TEMPO DE SUBIDA AJUSTÁVEL, CICLO MANUAL, ANALISADOR DE OXIGÊNIO, SAÍDA SERIAL, SILENCIADOS DE ALARME ATÉ 120 SEGUNDOS, POSSIBILIDADE DE CAPNOGRAFIA INTEGRADO AO EQUIPAMENTO, ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O PRODUTO: BRAÇO ARTICULADO PARA APOIO DO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, BASE COM 4 RODÍZIOS SENDO 2 DELES COM TRAVA, DEVERÁ ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO: 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES NEONATAIS/PEDIÁTRICOS, 02 CIRCUITOS PARA PACIENTES ADULTOS, UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADOR, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO COM O<sub>2</sub> E AR COMPRIMIDO, SE UTILIZAR CÉLULA GALVÂNICA, PELO MENOS 4 CÉLULAS DE FIO<sub>2</sub>. O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. O LICITANTE DEVE FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS SEM ÔNUS PARA A ADMINISTRAÇÃO."

Quanto a Leistung.

Equipamento ofertado pela empresa vencedora, não atende ao requisito sensibilidade a pressão. Edital solicita que seja de 0 a -20 cmH<sub>2</sub>O, porém o equipamento ofertado faz apenas -0,5 a -15 cmH<sub>2</sub>O.

Quanto a empresa Magnamed

Equipamento ofertado pela empresa Magnamed não possui Umidificador Aquecido com controle eletrônico de temperatura de 28°C a 37°C com alarmes de visual de baixa umidade e alta temperatura.

Dessa forma nenhuma das empresas concorrentes ofertou equipamento que atenda ao descritivo.

#### **DO PEDIDO**

- 1- Que a empresa MCA seja declarada a vencedora do processo em questão visto que foi a única a apresentar proposta dentro descritivo solicitado no edital para o item 15;



São José, 12/12/2019

**PEDEDEFERIMENTO**

MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA  
CNPJ/MF SOB n.º15.229.902/0001-71  
BRUNO CECHETTO DE ARAÚJO – PROPRIETÁRIO  
CPF/MF Nº 034.603.439-66



**De:** Bruno Araujo - MCA Hospitalar <comercial@mcahospitalar.com.br>  
**Enviado em:** quinta-feira, 12 de dezembro de 2019 13:36  
**Para:** licitacao@luizalves.sc.gov.br; licitacao01@luizalves.sc.gov.br  
**Assunto:** Recurso MCA Pregão Pres. 13/2019  
**Anexos:** Recurso MCA Luiz Alves.pdf

Boa tarde,

conforme acertado ontem na sessão pública do pregão presencial 13/2019, venho através deste interpor o recurso para o item 15.

Obrigado

favor acusar o recebimento.

---

Bruno Cechetto Araujo  
Gerente Comercial  
MCA Hospitalar